


AGGIORNAMENTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE 10/2023
(18/12/2023)

1. Da “Impostazioni ➤ App ➤ App e funzionalità” verificare che non visiano sistemi di firma ~~di~~ obsoleti. (Es: DikeUtil, Dike, ecc.ecc.)
Nel caso siano presenti, eseguirne la disinstallazione.
2. Download di GoSign desktop, dal seguente link:
<https://www.firma.infocert.it/installazione/> ➤ Applicazione per Windows, MacOS o **Linux**.
3. Installazione di GoSignDesktop;
4. Download ed i nstallazione di:
 - Bit4 ➤ https://www.firma.infocert.it/software/bit4id_xpki_1.4.10.598.zip (decompressione s desktop ed “esegui come amministratore”);
 - Safe dive 4.12 ➤ https://d2nu8i0ja8i6qk.cloudfront.net/driver/SafeDive2023v.5.0.0_setup_minidriver.exe
5. Pulizia della cache della postazione e riavvio della medesima;
6. Aprire dall'icona desktop il programma SafeDive;
7. Menu in basso “Utilità” e click sul bottone “Importa” della riga “Certificati”;

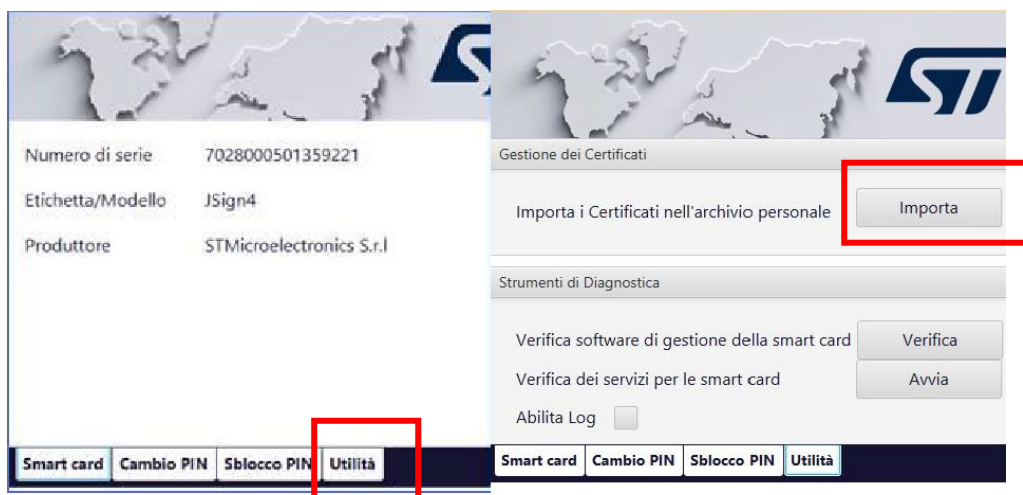

8. Prova di accesso con tutti i browser ai siti desiderati, dove sia necessaria l'autenticazione CNS.